

产品介绍

LEAK MASTER CHECKER



泄漏标准孔确认仪

LMC-120

便于进行泄漏标准孔的流量确认。

小巧便利、功能齐全。

■ 特长


(1) 可选择流量量程

- 流量传感器可在4个量程中最多选择2个量程使用。
- 可通过前面板更换流量传感器量程。
- 通过更换量程，流量测试范围变大，可管理更多的泄漏标准孔。

(2) 设定测试压很简便。

- 因为装有精密调压阀，可正确设定目标压力。
- 可用数字压力表确认测试压。
- 可选择低压(L型)或中压(M型)满足规格要求。

■ 回路图

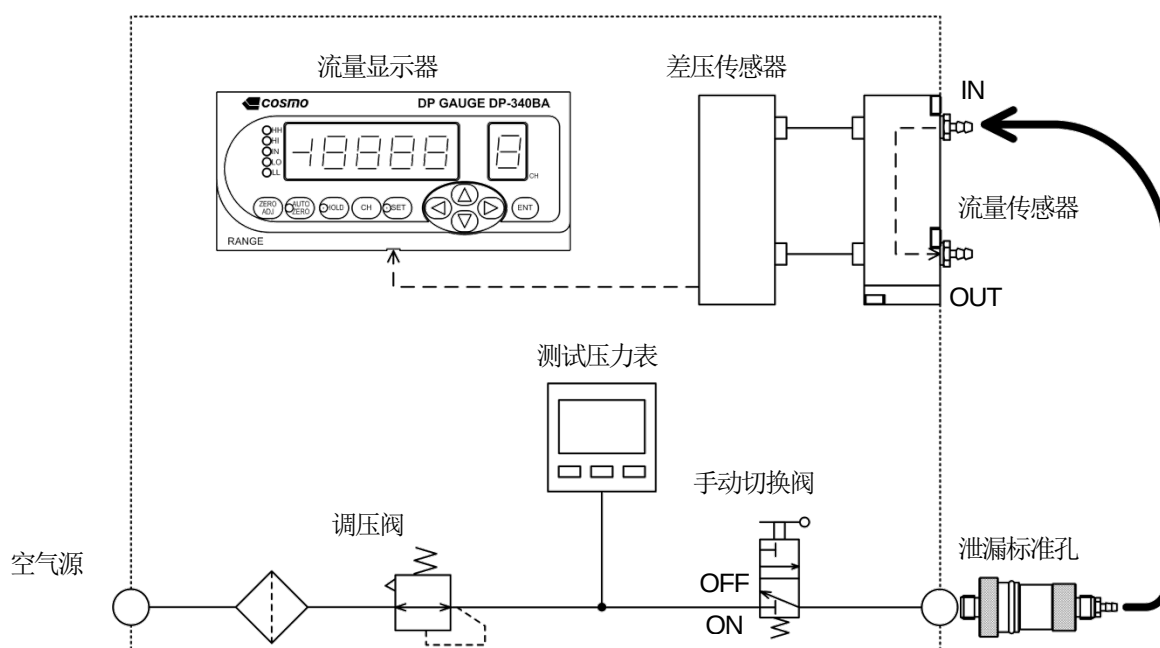

■ 规格

流量量程 (流量范围)	5 mL/min (0.00~5.00)
	20 mL/min (0.00~19.99)
	100 mL/min (0.0~100.0)
	200 mL/min (0.0~199.9)
测试压量程 (调整范围)	L (5~100 kPa)
	M (0.005~0.7 MPa)
流量测试精度	±2% of F.S.(校正时的温度)
温度保证范围和精度	流体温度 10~30℃时为±3.5% of F.S.
泄漏标准孔连接口径	M10 x 1.5
电源	AC 100V~240V ±10% (FUSE 0.5A 25VA MAX)
最大过压	10kPa
使用温度	5 ~ 40℃
重量	约 4kg


■ 规格型号分类表

LMC-120 (①,②③,④)

③所选择的第2个量程可选配。

①	压力量程	L	5~100 kPa
		M	0.005~0.7 MPa
②③	流量量程	5ML	5 mL/min
		20ML	20 mL/min
		100ML	100 mL/min
		200ML	200 mL/min
④	电源	VA	AC 125V 电线 3m
		VE	AC 240V 电线 2m
		VK	AC 250V 电线 2m(中国用)

■ 外观图

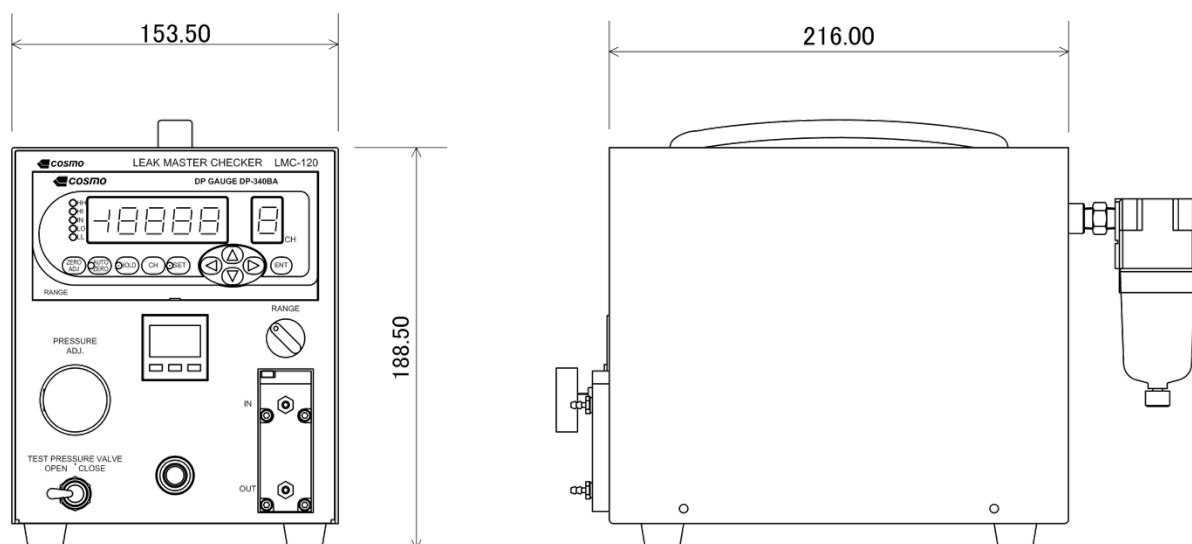

※本产品介绍内容编写于2018年10月，如有变更恕不通知。

科斯莫（上海）商贸有限公司

COSMO上海办事处

上海市虹口区四平路257号19E室 邮编200081

TEL. 021-6575-6880 FAX. 021-6575-6882

<http://www.cosmo-k.net.cn/>

天津: TEL. 022-2628-6748

广州: TEL. 020-6120-5933

重庆: TEL. 023-6172-5071

长春: TEL. 0431-8876-2711

武汉: TEL. 027-8488-5768

FAX. 022-2628-8468

FAX. 020-6120-5932

FAX. 023-6172-5073

FAX. 0431-8587-3017

FAX. 027-8488-9768

株式会社 **COSMO** 計器

总公司 〒192-0032 东京都八王子市石川町2974-23

TEL(042)642-1357 FAX(042)646-2439

<http://www.cosmo-k.co.jp/>